


DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego z dnia 06.07.2021 r. **dot. dostawy automatycznej wywoływarki RTG dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.**

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczną wywoływarkę do zdjęć rtg o gabarytach: 77 x 59 x 42 cm (dł. x szer. x wys.) bez podstawy lub 77 x 59 x 112 cm (dł. x szer. x wys.) z podstawą, pod którą umieszczane są dwa 25 litrowe zbiorniki ze świeżymi odczynnikami (regeneracyjnymi) oraz zbiorniki na odczynniki zużyte jak na załączonym rysunku i zdjęciu?

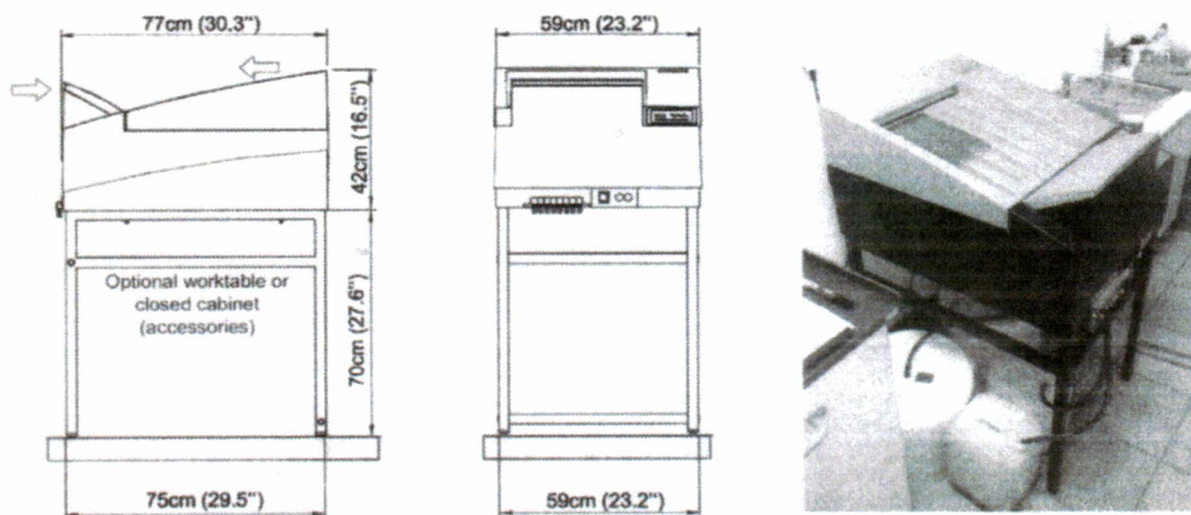

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wywoływarkę o podanych w zapytaniu wymiarach z podstawą.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczną wywoływarkę do zdjęć rtg, w której nie ma określonego czasu nagrzewania odczynników? Producent w instrukcji użytkowania podaje czas tzw. start-cycle (tłum. cykl startowy), określony jako czas 8 minut, w trakcie którego odczynniki nagrzewają się i nalewana jest woda do zbiornika płukania w przypadku podłączenia wywoływarki do sieci wodociągowej. Może być tak, że odczynniki nagrzewają się wcześniej lub później, czas nagrzania odczynników może być różny i jest zależy od ustawienia temperatury docelowej na panelu sterowania, zastanej temperatury odczynników w tankach roboczych i temperatury zewnętrznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wywoływarke bez określonego czasu nagrzewania odczynników, natomiast wymaga podania alternatywnego sposobu zasilania wodą, biorąc pod uwagę brak możliwości podłączenia zaoferowanego urządzenia do sieci wodociągowej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczną wywoływarke do zdjęć rtg, w której szybkość wywoływania (przesuwu filmu) wynosi 30 cm/min, co odpowiada całkowitemu czasowi procesu 167 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wywoływarke, w której szybkość przesuwu kliszy wynosi 30 cm/min.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczną wywoływarke do zdjęć rtg, w której temperatura suszenia wynosi 67 st. C.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wywoływarke, w której temperatura suszenia wynosi 67 st.C

**Zamawiający przedłuża jednocześnie termin
składania ofert cenowych do dnia 23.07.2021 r.**

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotuła

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Aparatury Medycznej

inż. Weronika Smolarz

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

**KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

mgr Urszula Wojcieszek

Dyrekcja

Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07

onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Centrala

Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028